BEING Tulip 100A

Kurzanleitung – Bedienelemente & Funktionen



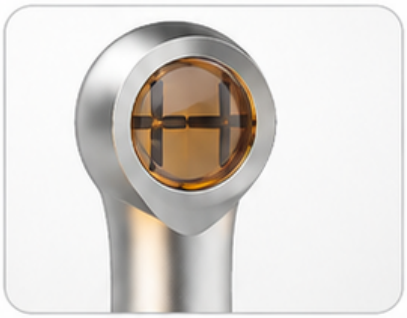

Ein / Aus
Die M/T-Taste kurz drücken.

Start / Stopp
Die M/T-Taste kurz drücken.

Modus wechseln
Die Funktionstaste kurz drücken.

Zeit einstellen
Die M/T-Taste lang drücken, bis die Zeit blinkt, dann durch kurzes Drücken die gewünschte Zeit wählen.

Übersicht der Modi

M1	**Standard-Modus**	5 / 10 / 15 / 20 s	Universeller Aushärtungsmodus (1.000 – 1.300 mW/cm²)
M2	**Sanftstart-Modus**	3 / 4 / 5 s	Sanfte Intensitätssteigerung (1.800 – 2.100 mW/cm²)
M3	**Hochleistungs-Modus**	1 / 2 / 3 s	Schnelle Aushärtung (2.700 – 3.100 mW/cm²)
M4	**Dauerlicht-Modus**	3 / 5 / 10 / 30 s	Konstante Lichtleistung (2.700 – 3.100 mW/cm²)
M5	**Kariesdetektor**	30 / 60 s	Fluoreszenzmodus zur Karieserkennung (nicht zum Aushärten von Kompositen)
M6	**Pulsmodus**	5 / 10 / 15 / 20 s	Gepulstes Licht (1.000 – 1.300 mW/cm²)
M7	**Progressiv-Modus**	5 / 10 / 20 s	Stufenweise Leistungssteigerung (1.000 – 1.200 mW/cm²)

Akkustand
Der Akkustand wird im Display angezeigt.

Laden
Das Gerät auf die Ladestation stellen. Während des Ladens wird der Ladezustand im Display angezeigt.

Wichtige Hinweise

- Der Modus **M5** (Kariesdetektor) ist ein Fluoreszenzmodus und darf **nicht** zum Aushärten verwendet werden.
- Nicht direkt in das Licht sehen und Augenkontakt vermeiden.
- Diese Kurzinformation dient nur zur Voransicht und ersetzt nicht die Original-Gebrauchsanweisung.
  Die vollständige Originalanleitung liegt der Ware bei und ist vor Inbetriebnahme, Anwendung, Reinigung und Wartung zu beachten.

3B Dental®

Importeur: ERORA GmbH (3B Dental), Akazienweg 22, 57078 Siegen ·
Telefon: 030-57712206 / 01579-2486569 · E-Mail: info@3bdental.de